


Aesculap® Hydrolift

FW461R Tray – Trial Implants

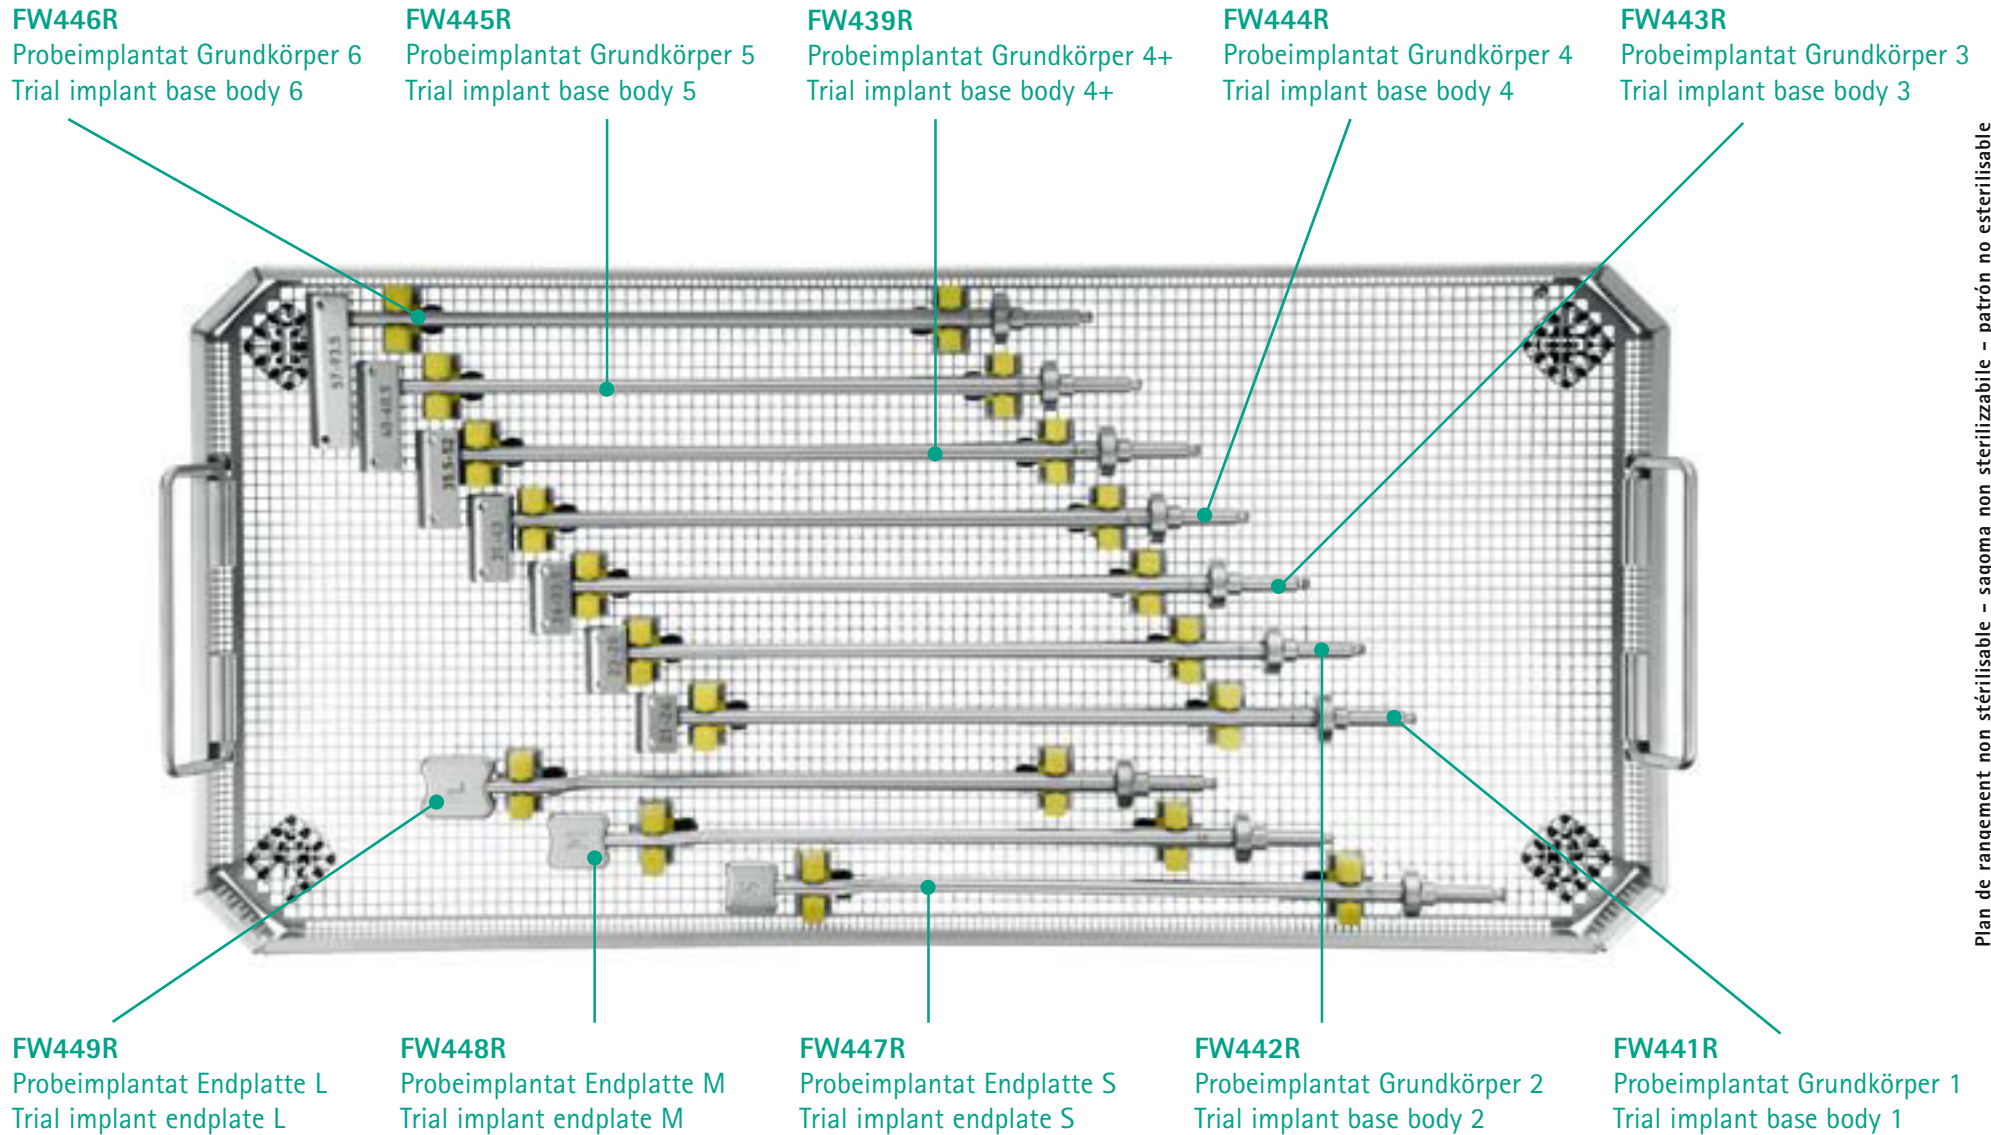

Plan de rangement non stérilisable – sagoma non sterilizzabile – patrón no esterilizable

Stencil non-sterilizable
Schablone nicht sterilisierbar